







Messblatt für Soft Feel Sonderanfertigungen

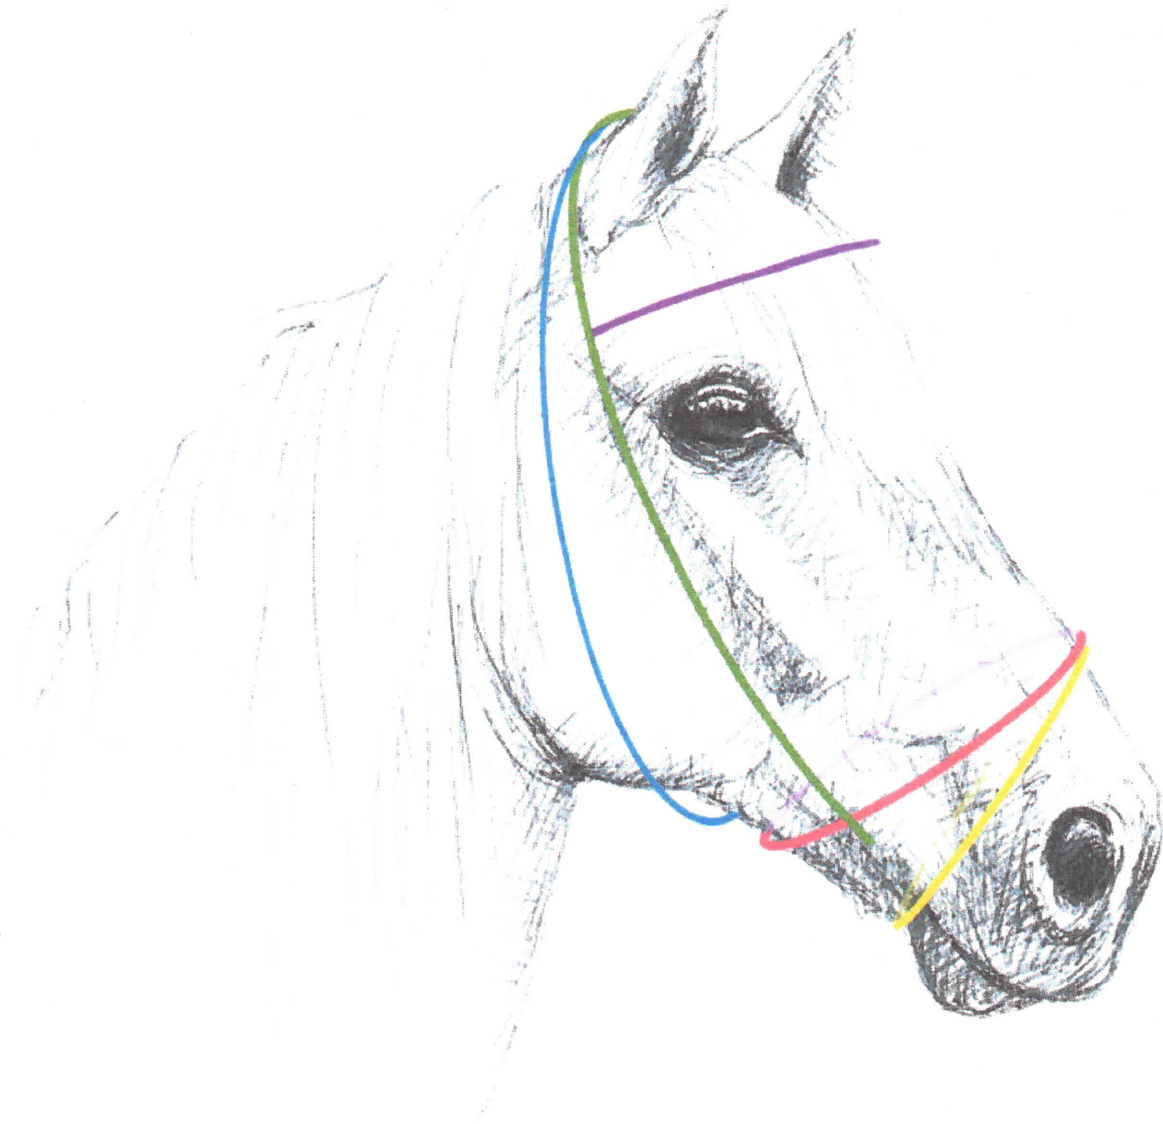

Bitte geben Sie für alle Riemen die Länge/den Umfang der benötigten Einstellung an!

 Umfang Sperrriemen	_____ cm
 Umfang Nasenriemen (bei Englisch-Trensen geben Sie bitte zusätzlich die lichte Weite zwischen den Backenriemen an)	_____ cm (_____ cm)
 Länge Stirnriemen (bitte messen Sie hier die lichte Weite zwischen den Backenriemen)	_____ cm
 Länge Backenstück	_____ cm
 Umfang Kehlrriemen	_____ cm